



ClinMax™ 人白介素8 (IL-8) 定量测定试剂盒

货号: CEA-C004

规格: 96 tests

本试剂盒仅用于科研使用，不可用于诊断或治疗应用。

重要提示：在进行实验前，请仔细阅读本用户指南。

产品信息

本试剂盒用于定量检测生物样本（细胞上清、血清、血浆）中人白介素 8（IL-8）的浓度。

本试剂盒的测定原理采用定量夹心酶联免疫分析法。首先在微孔板上包被捕获抗体，然后将待测样本加入孔中，样品中的待测抗原与捕获抗体结合。随后，加入另一个生物素标记的检测抗体，这个特异抗体与待测抗原的另一表位结合，从而形成“夹心”结构。最后，通过加入 Streptavidin-HRP 与生物素标记的检测抗体结合，使得酶标记物与夹心结构关联起来。添加适当的底物后，酶催化底物反应产生可测量的信号，从而定量检测待测抗原的含量。

注意事项：

本试剂盒仅供科研使用，不用于诊断或治疗应用。

请勿在试剂盒标签上指示的到期日期之后使用本试剂盒。

请勿将试剂与其他批次或来源的试剂混合或替换。

生产企业：百斯医学诊断科技（北京）有限公司

生产地址：北京经济技术开发区永昌北路 3 号永昌工业园 3 号楼 8106-8107

电话：010-67855298-8147

邮箱：IVD.AcroDiagnostics@acrobiosystems.com

销售企业：北京百普赛斯生物科技股份有限公司

地址：北京经济技术开发区宏达北路 8 号 5 号楼 4 层

电话：400-682-2521（全国） 010-53681107（北京）

邮箱：order.cn@acrobiosystems.com

试剂盒组分

该试剂盒包含足够的试剂用于96孔。

Catalog	Contents	Amount
CEA004-C01	Pre-coated Anti-IL-8 Antibody Microplate	1 plate
CEA004-C02	IL-8 Calibrator	20 µg×2
CEA004-C03	Biotin-Anti-IL-8 Antibody Concentrated Solution	100 µL
CEA004-C04	Biotin Antibody Dilution Buffer	8 mL
CEA004-C05	IL-8 Streptavidin- HRP Concentrated Solution	0.5 mL
CEA004-C06	Streptavidin- HRP Dilution Buffer	15 mL
CEA004-C07	20× Washing Buffer	50 mL
CEA004-C08	Sample Dilution Buffer	15 mL×2
CEA004-C09	Substrate Solution	12 mL
CEA004-C10	Stop Solution	6 mL

存储条件

将未开封的试剂盒存储在 2-8 °C 温度下。请避免在试剂盒的过期日期之后使用。对于已开封的试剂盒，除了微孔板和重构的标准品按照下表进行特殊存储，其余组分可在 2-8 温度下，保存 30 天。

Contents	Storage conditions
Pre-coated Anti-IL-8 Antibody Microplate	Return unused wells to the foil pouch, reseal along entire edge. May be stored for up to 1 month at 2-8°C.
IL-8 Calibrator	Aliquot and store for up to 1 month at -70°C in a freezer. Avoid repeated freeze-thaw cycles.


注意：Streptavidin-HRP Con. Solution 和 Substrate Solution 需避光保存。

需要但未提供的试剂/设备

设备	酶标仪
试剂	超纯水/去离子水/蒸馏水
耗材	50 mL 和 500 mL 量筒
	移液器和枪头
	用于稀释标准品的 EP 管

工作流程

Analyte: IL-8

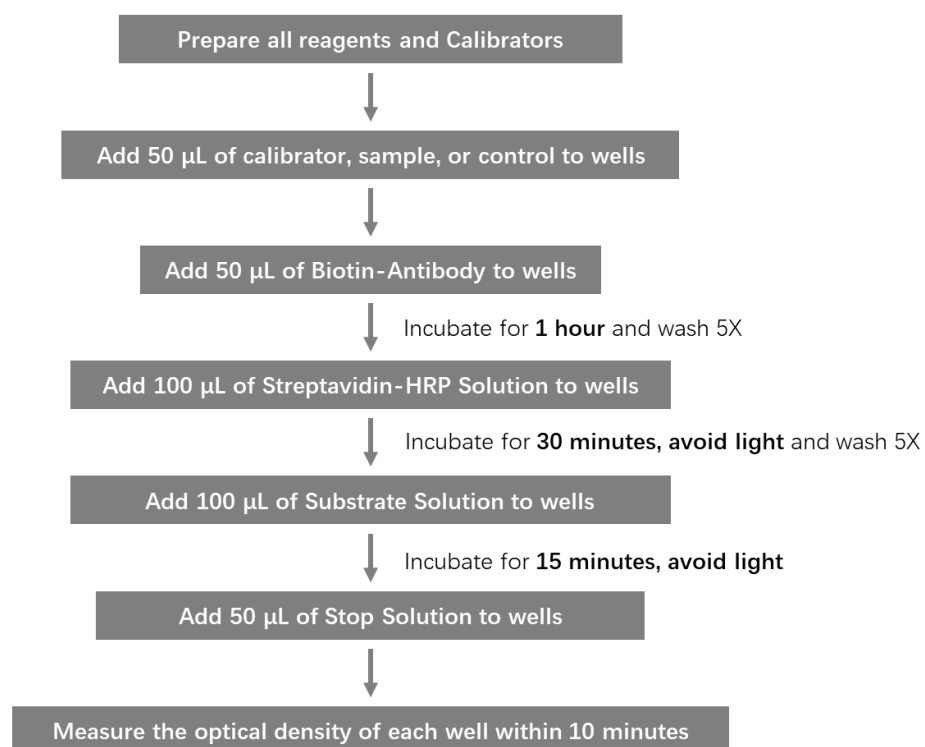

NOTE: Incubation temperature is 18 °C-25 °C

工作液和梯度标准品的制备

注意事项：使用前将所有试剂置于室温（18°C~25°C）。如果在缓冲溶液中形成晶体，请将试剂置于37°C培养箱中，直至晶体完全溶解，然后在使用前将溶液恢复至室温。

工作液的制备

1. 1×Washing Buffer: 用超纯水/去离子水/蒸馏水将 50 mL 20×Washing Buffer 稀释至 1000 mL。
2. Biotin-Anti-IL-8 Antibody Solution: 取 60 μ L Biotin-Anti-IL-8 Antibody Concentrated Solution 加入 6 mL Biotin-Antibody Dilution Buffer, 轻轻摇匀, 现用现配。
3. IL-8 Streptavidin-HRP Solution: 取 300 μ L IL-8 Streptavidin- HRP Concentrated Solution 加入 12 mL Streptavidin-HRP Dilution Buffer, 轻轻摇匀, 该工作液需避光保存, 现用现配。

标准品的重构

用 1.0 mL 超纯水将所提供的标准品（CEA004-C02）配制成储存液，在室温下溶解 15 至 30 分钟，轻轻吹吸混匀。重构后的 IL-8 标准品储存液浓度为 20 μ g/mL。

备注：避免剧烈摇动或涡旋，分装后存储在-70°C。避免反复冻融。

梯度标准品的制备

1. 将一个试管标记为“Cm”，取 10 μ L 标准品储存液（20 μ g/mL）和 990 μ L 样本稀释液（Sample Dilution Buffer）加入 Cm 的管中，轻轻振荡混匀；
2. 准备 7 个 EP 管，分别标记为 Cal.-1, Cal.-2, Cal.-3, Cal.-4, Cal.-5, Cal.-6, Cal.-7；
3. 标准曲线配置如下：在 Cal.-1 管中加入 4 μ L Cm 溶液和 1996 μ L 样本稀释液，作为标曲的最高点 Cal.-1（400 pg/mL），轻轻振荡混匀；
4. 在 Cal.-2 管中加入 500 μ L Cal.-1 溶液和 500 μ L 样本稀释液，作为标曲的 Cal.-2（200 pg/mL）；
5. 后续按照此方法继续依次 1: 1 稀释至（100 pg/mL, 50 pg/mL, 25 pg/mL, 12.5 pg/mL, 6.25pg/mL），共配 7 个标准曲线浓度点；
6. 以样本稀释液作为标准曲线的零浓度。

实验流程：


1. 向微孔板中加入 50 μL IL-8 Calibrator 或样品。
2. 向微孔板中加入 50 μL Biotin-Anti-IL-8 Antibody Solution。用密封膜密封微孔板，在室温（18 $^{\circ}\text{C}$ ~25 $^{\circ}\text{C}$ ）下孵育 **1.0 小时**。
3. 吸出剩余溶液，向每孔中加入 300 μL 1 \times Washing Buffer，轻轻敲击板 1 分钟，去除任何剩余的 1 \times Washing Buffer：通过吸出或倾倒，倒置板并用纸巾吸干。重复上述洗涤步骤，总共五次。
4. 向微孔板中加入 100 μL Streptavidin-HRP Solution。用密封膜密封微孔板，在室温（18 $^{\circ}\text{C}$ ~25 $^{\circ}\text{C}$ ）下孵育 **30 分钟，避光**。
5. 重复步骤 3。
6. 向微孔板中加入 100 μL Substrate Solution，用密封膜密封微孔板并在室温（18 $^{\circ}\text{C}$ ~25 $^{\circ}\text{C}$ ）下孵育 **15 分钟，避光**。
7. 向微孔板中中加入 50 μL Stop Solution，轻轻敲击板以充分混合。终止反应后，**十分钟内上机读数**。
注意：孔中的颜色应从蓝色变为黄色。
8. 使用酶标仪测定读取 450nm 和 630nm 处的吸光度。
注意：为了减少背景噪音，用 450nm 读取的值减去 630nm 读取的值。

结果解读

1. 标准曲线的范围: $R^2 \geq 0.9900$ 。
2. 如果待测样品的 OD 值高于最高标准, 应将样品用稀释缓冲液稀释后重复测定。
3. 校准标准曲线得到的吸光度值, 以标准浓度为 x 轴, 校准吸光度值为 y 轴绘制标准曲线。四参数拟合用于绘制标准曲线并计算样品浓度。

典型数据

注意: For each experiment, a calibration curve needs to be set for each microplate, and the specific OD value may vary depending on different laboratories, testers, or equipment. The following example data is for reference only. The sample concentration was calculated based on the results of the calibration curve.

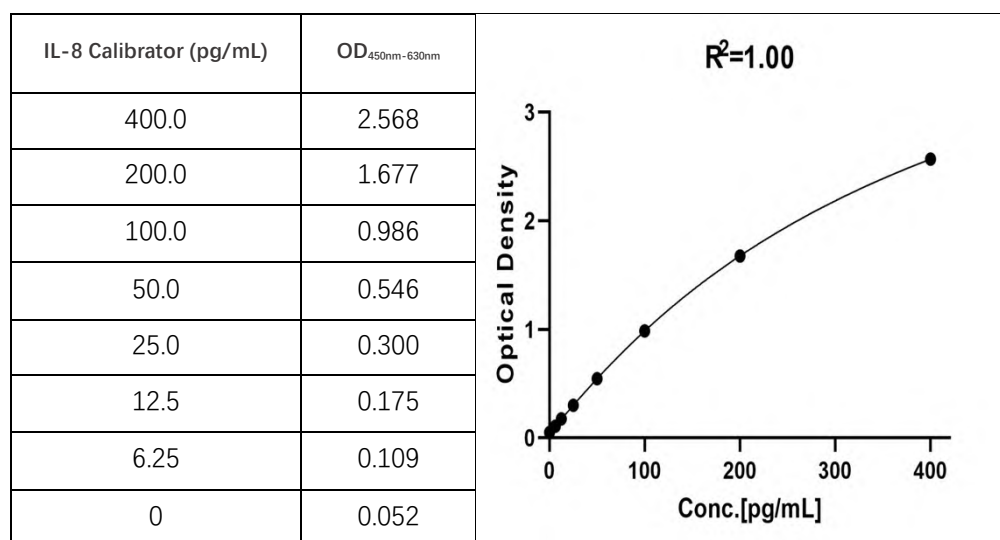


灵敏度

检测零浓度校准品 20 次, 得到 20 次测定结果的 OD 值, 计算其平均值 M 和标准差 SD, 将 M+2SD 所对应的 OD 值, 带入标准曲线中, 计算得出对应的浓度, 即最低检测限(Minimum detectable concentration, MDC)。IL-8 最低可检测限浓度小于 3.0 pg/mL。

稀释线性

将三份高值 IL-8 加标血清样本（浓度为 1500、1400 和 1200pg/mL）按 1:2、1:4、1:8、1:16、1:32 进行稀释，测定在线性范围内样品的值。从血清样本中平均可检测到 103.12% 的 EPO 蛋白。

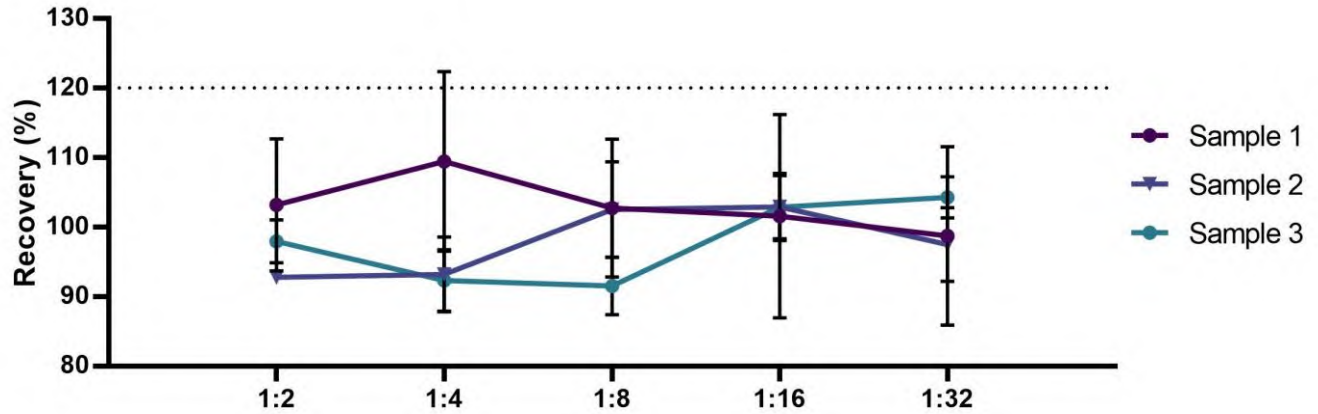

板内精密度

Sample Concentration (pg/mL)	Mean (pg/mL)	SD	Numbers	CV
400	422.8	15.39	10	3.64%
18.75	17.85	1.59	10	8.90%
6.25	6.85	0.62	10	9.07%

板间精密度

Sample Concentration (pg/mL)	Mean (pg/mL)	SD	Numbers	CV
400	407.47	18.71	3	4.59%
18.75	19.47	1.47	3	7.54%
6.25	6.33	0.52	3	8.26%

回收率


将重组人 IL-8 蛋白按照 1: 19 的稀释比例加标到 5 份人血清样品中，然后进行分析，回收率的计算公式 = (加标样本值 - Blank 样本值 * 0.95) / 理论值 * 100%。从血清样本中平均回收了 94.64% 的 IL-8 蛋白。

Sample ID	Conc Measured (pg/mL)	Conc Added (pg/mL)	Conc Recovered (pg/mL)	Recovery
1	439.34	400	433.84	108.46%
	325.78	300	320.28	106.76%
	186.21	200	180.71	90.35%
	5.79			
2	456.06	400	450.80	112.70%
	262.61	300	257.35	85.78%
	205.75	200	200.49	100.24%

	5.54			
3	367.29	400	363.40	90.85%
	270.17	300	264.91	88.30%
	174.29	200	169.03	84.51%
	4.1			
4	363.65	400	361.35	90.34%
	301.94	300	296.68	98.89%
	178.21	200	172.95	86.47%
	2.42			
5	388.52	400	386.53	96.63%
	278.93	300	276.94	92.31%
	175.94	200	173.95	86.97%
	2.1			

Hook 效应

IL-8 浓度高于 50ng/ml 不影响检测结果。

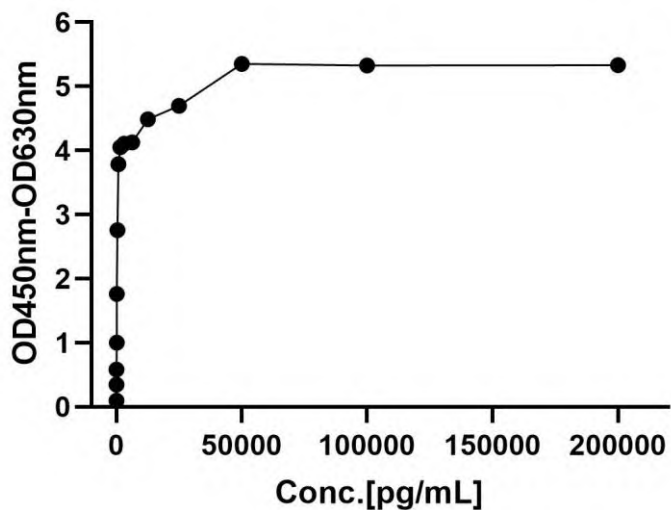

基质干扰

血红蛋白（模拟溶血）浓度不大于 2%，甘油三酯（模拟脂血）浓度不大于 3.0g/L，胆红素（模拟黄疸）浓度不大于 20mg/dL 不影响检测结果。


Spiked Material	ID	Conc-1 (pg/mL)	Conc-2 (pg/mL)	Mean (pg/mL)	Recovery
2% Hemoglobin (v/v)	Sample 1	106.42	95.90	101.16	101%
	Spiked Sample 1	97.17	107.40	102.28	
	Sample 2	2.24	2.12	2.18	85%
	Spiked Sample 2	1.77	1.95	1.86	

Spiked material	ID	Conc-1 (pg/mL)	Conc-2 (pg/mL)	Mean (pg/mL)	Recovery
Triglyceride (3 mg/mL)	Sample 1	113.81	100.32	107.06	100%
	Spiked Sample 1	99.18	100.32	107.06	
	Sample 2	1.38	1.59	1.49	120%
	Spiked Sample 2	1.82	1.74	1.78	

Spiked material	ID	Conc-1 (pg/mL)	Conc-2 (pg/mL)	Mean (pg/mL)	Recovery
Bilirubin (20 mg/dL)	Sample 1	99.53	116.61	108.07	97%
	Spiked Sample 1	102.49	107.97	105.23	
	Sample 2	1.49	1.59	1.54	120%
	Spiked Sample 2	2.02	1.66	1.84	

真实样本值

在该测定中，进行了 240 例人血清样本中 EPO 浓度检测，其中 240 个健康人样本。240 个样品测量值见下图。

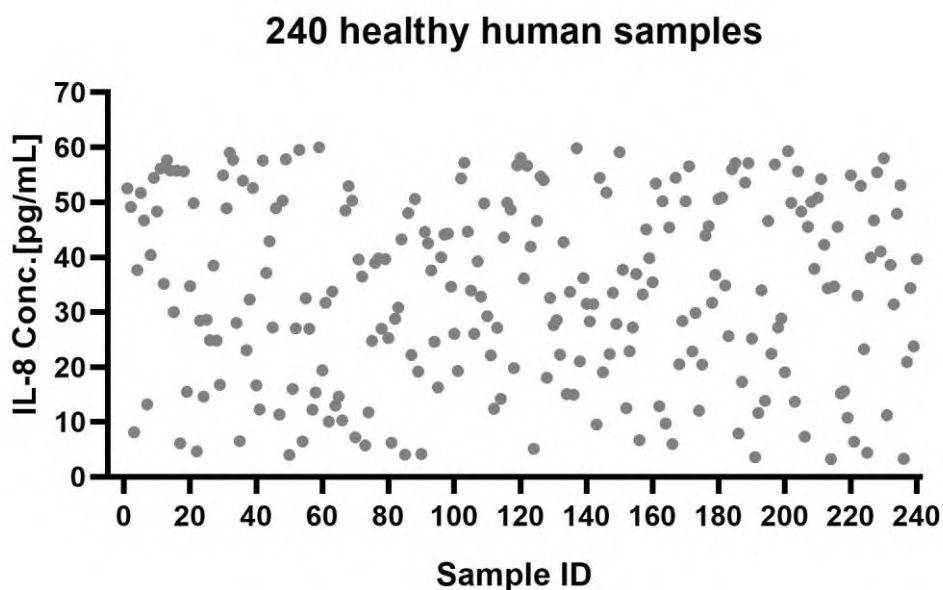

特异性

当该试剂盒用于分析高达 1 $\mu\text{g/mL}$ 以下的重组细胞因子时，未观察到交叉反应。

Human	IL-1 β , IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-12 p70, IL-10、IL-10、MCP-1、M-CSF、TNF- α 、IFN- γ
-------	--

校准品校准

该试剂盒是针对 ACROBiosystems 生产的高度纯化的重组人 IL-8 蛋白进行校准的，可溯源至 NIBSC/WHO 国际标准品 (89/520)。

常见问题指南

问题	原因	解决方法
标准曲线差	* 移液不准确	* 检查移液器
CV 值偏高	* 移液不准确 * 孔中有气泡	* 检查移液器 * 去除孔中的气泡
背景高	* 板子清洗不充分 * 洗涤缓冲液被污染	* 按操作步骤正确清洗 * 制备新的洗涤缓冲液

整板读数偏低	<ul style="list-style-type: none">* 波长选择错误* 孵育时间不足	<ul style="list-style-type: none">* 检查波长参数* 增加孵育时间
标准曲线正常，样品读值高	<ul style="list-style-type: none">* 样本中的细胞因子水平高于检测范围	<ul style="list-style-type: none">* 稀释样本再次进行检测
曲线漂移	<ul style="list-style-type: none">* 加样时间过长* 试剂不在室温下	<ul style="list-style-type: none">* 在检测开始之前准备好所有的标准品和样品，尽量控制加样时间* 除非抗体等物质有特殊说明，否则在加样前所有试剂都处于室温状态