

水痘-带状疱疹病毒(VZV) gE蛋白定量检测试剂盒

(酶联免疫分析法)

【产品名称】

水痘-带状疱疹病毒(VZV) gE蛋白定量检测试剂盒

【规格】

96 Tests

【货号】

RAS-A102

【预期用途】

本试剂盒用于水痘-带状疱疹病毒(VZV) gE蛋白特异性定量检测。

【检测原理】

本试剂盒应用ELISA夹心法。微孔板预包被了Anti-Glycoprotein E (VZV) Antibody，样本中的Glycoprotein E (VZV)与微孔板上固定的Anti- Glycoprotein E (VZV) Antibody结合，然后加入Biotin-Anti- Glycoprotein E (VZV) Antibody，形成抗体-抗原-生物素标记抗体复合物，最后加入Streptavidin-HRP，用底物显色，随后用终止液终止，板孔中溶液会由蓝色变为黄色，使用酶标仪在450 nm和630 nm处测定样品吸光度值（ $OD_{450\text{ nm}}$ 、 $OD_{630\text{ nm}}$ ）， $OD_{450\text{ nm}} - OD_{630\text{ nm}}$ 与样本中的水痘-带状疱疹病毒(VZV) gE蛋白含量呈正相关。

【产品组份】

表1.产品组份

ID	组份名称	规格 (96 T)	物理状态	存储条件	
				未开启	已开启
RAS102-C01	Pre-coated Anti-Glycoprotein E (VZV) Antibody Microplate	1 plate	固体	2-8°C	2-8°C
RAS102-C02	Glycoprotein E (VZV) Standard	30 µg	冻干粉	2-8°C	-70°C
RAS102-C03	Biotin-Anti-Glycoprotein E (VZV) Antibody	20 µg	冻干粉	2-8°C	-70°C
RAS102-C04	Streptavidin-HRP	50 µL	液体	2-8°C, 避光	2-8°C, 避光
RAS102-C05	10xWashing Buffer	50 mL	液体	2-8°C	2-8°C
RAS102-C06	2xDilution Buffer	50 mL	液体	2-8°C	2-8°C
RAS102-C07	Substrate Solution	12 mL	液体	2-8°C, 避光	2-8°C, 避光
RAS102-C08	Stop Solution	7 mL	液体	2-8°C	2-8°C

【储存条件及有效期】

1. 未开封：试剂盒保存于2-8°C，试剂盒自生产之日起有效期为12个月，有效期见外包装标签。
2. 已开封：试剂盒开封后各组分按照表1存储条件保存，有效期自开封之日起为30天，未使用完的微孔板条需与干燥剂一起密封保存。

注：1. 不要使用过期试剂。

2. 冻干粉重构后需-70°C储存，建议分装规格不低于5 µg，冻融次数不要超过1次。

【需要但未提供的实验仪器与耗材】

1. 单道、多道微量移液器和移液器吸头：需满足10 µL、300 µL、1000 µL加样需求
2. 恒温培养箱
3. 酶标仪，含450 nm/630 nm波长

4. 离心管：1.5 mL，10 mL
5. 计时器
6. 试剂瓶
7. 超纯水或去离子水

【试剂准备】

使用前将所有试剂恢复至室温 (20°C-25°C)。如果溶液中有晶体形成，需平衡溶液至晶体完全溶解（可将溶液放置于恒温培养箱37°C平衡10-15 min）。

按照表2建议，用超纯水将所提供的冻干品配制成存储溶液，在室温下溶解15至30分钟，轻轻吹吸混匀，避免剧烈摇动或涡旋。重构的存储液应在-70°C保存，建议分装规格不低于5 µg，冻融次数不要超过1次。

表2. 配制方法

ID	组份名称	规格 (96 T)	存储液浓度.	重构水体积Vol.
RAS102-C02	Glycoprotein E (VZV) Standard	30 µg	200 µg/mL	150 µL
RAS102-C03	Biotin-Anti-Glycoprotein E (VZV) Antibody	20 µg	100 µg/mL	200 µL

【检测流程】

1. 工作液配制

1.1 配制1×Washing Buffer:

取50 mL 10×Washing Buffer，用超纯水/去离子水稀释并定容至500 mL。

1.2 配制1×Dilution Buffer:

取50 mL 2×Dilution Buffer，用1×Washing Buffer稀释并定容至100 mL。

1.3 配制Biotin-Anti-Glycoprotein E (VZV) Antibody工作液:

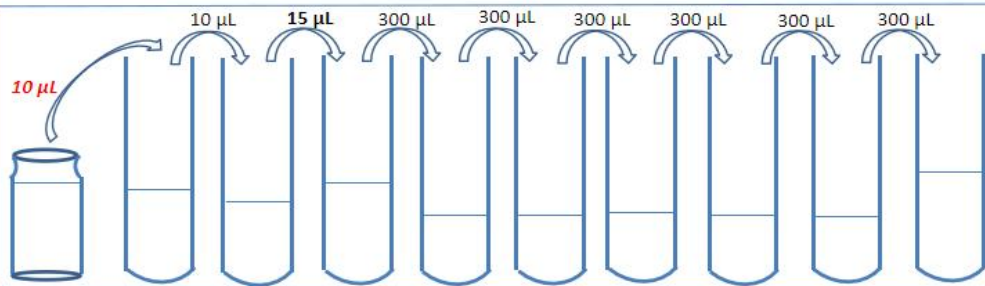
用1×Dilution Buffer将Biotin-Anti-Glycoprotein E (VZV) Antibody储存液稀释至0.5 µg/mL, 需现用现配。

1.4 配制Streptavidin-HRP工作液:

用1×Dilution Buffer将Streptavidin-HRP进行2000倍稀释, 该工作液避光保存, 需现用现配。

2. 制备标准曲线

复溶后标准品(RAS102-C02)的浓度为 **200 µg/mL**, 取 10 µL 的标准品储存液, 加入 490 µL 的稀释液, 作为 Std.-0(4000 ng/mL), 然后取 Std.-0 溶液 10 µL, 加入到 390 µL 的稀释液中(Std.-1'), 最后取 Std.-1' 溶液 15 µL, 加入到 585 µL 的稀释液中, 作为标准曲线的最高浓度 **Std.-1(2500 pg/mL)**。在后续每一个离心管中加入 300 µL 稀释液, 使用高浓度标准品做 1:1 系列稀释。每次移液时, 确保充分混匀。以稀释液作为标准曲线的零浓度。

Tubes/ Solution Code	Glycoprotein E (VZV) Standard stock solution	Std.-0	Std.-1'	Std.-1	Std.-2	Std.-3	Std.-4	Std.-5	Std.-6	Std.-7
Operating										
Solution Con.	200µg/mL	4000 ng/mL	100 ng/mL	2500 pg/mL	1250 pg/mL	625 pg/mL	312.5 pg/mL	156.3 pg/mL	78.1 pg/mL	39.1 pg/mL
Dilution Buffer Vol.		490 µL	390 µL	585 µL	300 µL	300 µL	300 µL	300 µL	300 µL	300 µL

3. 加样

将待测样品和系列稀释后的标准品加入反应孔内, 每孔加入 100 µL, 空白对照孔加入 100 µL

1×Dilution Buffer。

注：待测样品和标准曲线建议设置复孔。

4. 孵育

用封板膜封板，室温孵育 1.0 h。

5. 洗板

小心揭开封板膜。弃去孔中液体，每孔加入 300 μ L 1×Washing Buffer，浸泡 30 s，共洗板 3 次。

6. 加 Biotin-Anti-Glycoprotein E (VZV) Antibody

在对应板孔内加入 100 μ L 的 **Biotin-Anti-Glycoprotein E (VZV) Antibody (稀释至 0.5 μ g/mL)** 工作液，该工作液现用现配，依次重复操作步骤 4 孵育及步骤 5 洗板。

7. 加 Streptavidin-HRP

在对应板孔内加入 100 μ L 的 **Streptavidin-HRP (1:2000 稀释)工作液**，该工作液现用现配，依次重复操作步骤 4 孵育及步骤 5 洗板。

8. 显色

将微孔板拍干，每孔加入 100 μ L Substrate Solution。用封板膜封板，室温避光孵育 20 min。

9. 终止

每孔加入 50 μ L Stop Solution，轻轻震荡酶标板至混合均匀。

注：孔中液体由蓝色变为黄色。

10. 读数

用酶标仪测定各孔在 450 nm 和 630 nm 波长的吸光值，请在终止后 5 分钟内读数。

注：各孔OD_{450 nm}扣除OD_{630 nm}读值可降低背景干扰。

【结果分析】

1. 标准曲线 R^2 应大于 0.9900，检测范围为 39.1-2500 pg/mL。
2. 如果待测样品 OD 值超过标准曲线最高点，需将待测样品用样品稀释液进行稀释并重新测定。
3. 将标准曲线和待测样品的 OD 值，扣减空白孔的 OD 值后得到校准的吸光度值。以标准品的浓度为横坐标，用校准的吸光度值为纵坐标，绘制标准曲线。利用四参数拟合进行绘制标准曲线并进行样品浓度的计算。若使用直线拟合，需选取合适的作图区间绘制标准曲线，以保证浓度计算的准确性。

【注意事项】

1. 本产品仅供科研使用，不能用于治疗 and 诊断。
2. 请严格按使用说明进行操作。
3. 不同批号的试剂不能混用。不可与其他厂家试剂混用。
4. 使用前各组份需平衡至室温，保证溶液晶体全部溶解。请在无尘洁净的环境下进行操作使用。
5. 试剂盒请在 2-8°C 保存，请勿使用过有效期的试剂盒。
6. 请根据实验需要配制各组份工作液，除 1xWashing Buffer 以外，工作液即配即用，不可保存。

【TYPICAL DATA】

以下数据仅供参考，以实验测定的标准曲线结果进行样本浓度计算。

Glycoprotein E (VZV) Standard(pg/mL)	OD450-630nm	OD450-630nm-Blank
2500	2.101	2.032
1250	1.422	1.353
625	0.783	0.714
312.5	0.462	0.393
156.25	0.248	0.179
78.125	0.157	0.088
39.0625	0.115	0.046
Blank	0.069	0.000

